


画像診断は高画質、低被ばくの時代へ。

被ばく線量を抑えながらも高画質画像を撮影できる
デジタルX線撮影システム。

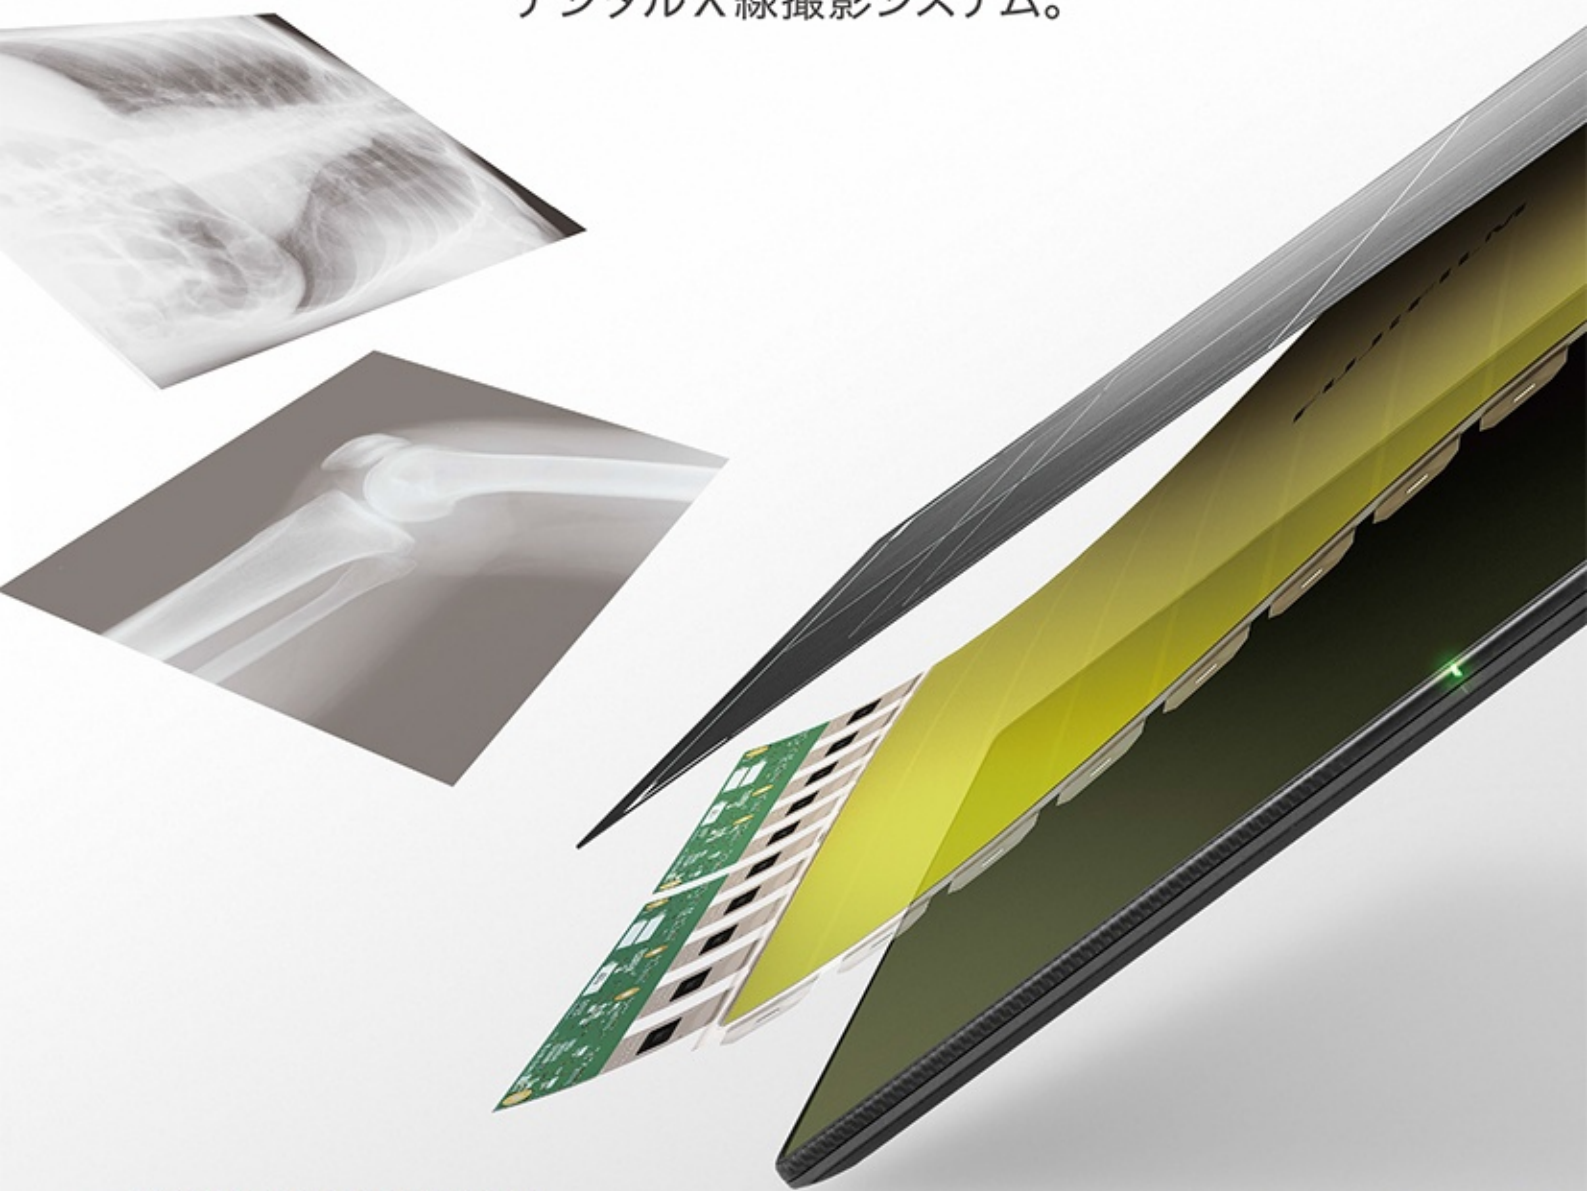

一般X線撮影間接変換 フラットパネルディテクタ装置

被ばく線量を従来システム(CR)と比較して約50%
低く抑えながらも高画質な画像を撮影できるため、
患部をしっかり診ることができ、不要な被ばくを避ける
ことができます。

高 速

高画質

高感度

